


# Einlegehinweise - Accuject Back-loaded ACUNEX® Familie mit Schlaufen-Haptik




ACUNEX AN6  
ACUNEX Quantum AN6Q



ACUNEX Vario AN6V  
ACUNEX Variomax AN6VM




ACUNEX Vario toric AN6V T0-T3  
ACUNEX Variomax toric AN6VM T0-T3

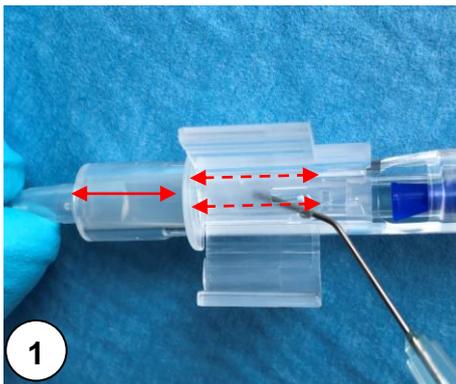


1

Kartuschenspitze und Ladekammer **unterhalb** der Abdeckung mit Viskoelastikum befüllen.

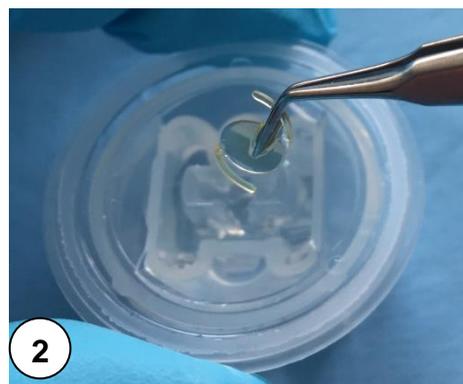


2

IOL behutsam mit einer Pinzette aus der IOL-Halterung nehmen.  
**Keine verzahnte Pinzette benutzen!**

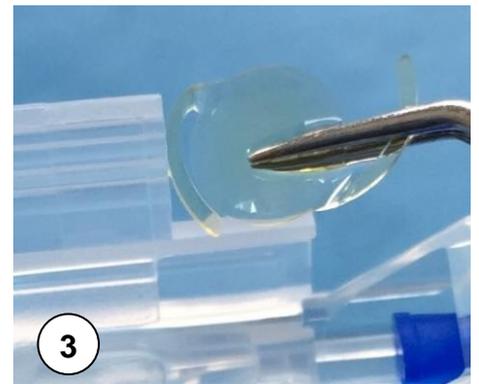


3

Vordere Haptik vorsichtig zur Optik drücken - **gewährleistet anliegende Haptik bei der Implantation!**

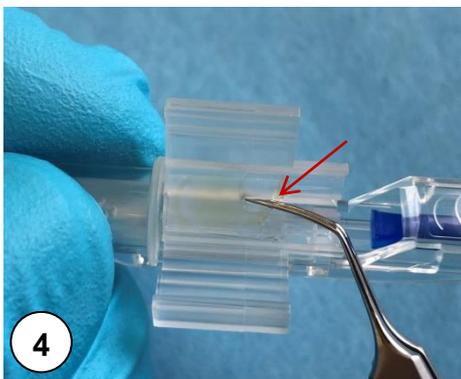


4

IOL unter der Abdeckung platzieren.  
**IOL mit hinterer Haptik bis zum Ende der Abdeckungsaussparung schieben.**

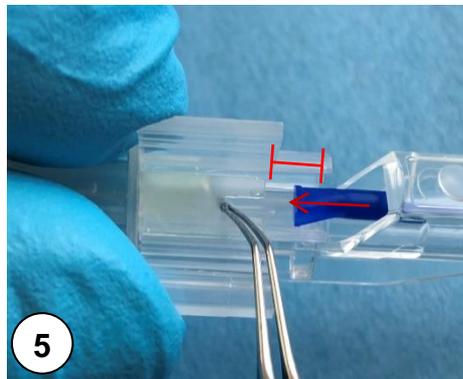

5

**Blauen Stempel in den rot markierten Bereich vorschieben, dann Kartusche schließen!**

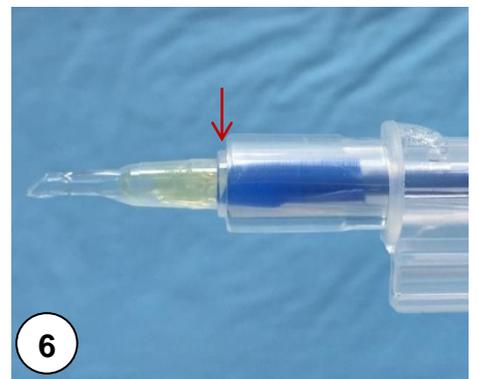

6

Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, Kolben kurz entlasten und IOL implantieren.

